

お客様各位

Ref : FESN-2502
2025年4月末日
富士電機株式会社

富士電機 船舶用排ガス浄化システム(EGCS)

Chelsea社製水質計(Sea Sentry)におけるソフトウェアアップデートについて
(注意喚起)

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、船舶用排ガス浄化システム(EGCS)をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

Chelsea社製水質計(Sea Sentry)を御使用いただいておりますお客様への注意喚起です。
センサメーカーの仕様変更に伴い、センサーの使用期間の算出基準日が、従来のメーカー校正日からセンサー使用開始日に変更となりました。
そのため、水質計本体のソフトウェアをVer.L0.2からL0.3にアップデートいただく必要がございます。
ソフトウェアは、下段リンクよりUSBメモリーにダウンロードしてお使いください。
アップデートしないで使用されますと濁度センサが壊れ、使用不可となりますのでご注意ください。
なお、弊社にセンサの校正作業をご依頼いただいたセンサにつきましては、作業完了後、最新バージョンのソフトウェアをインストールしたUSBとアップデート手順書を同梱して、出荷しております。
対象のお客様は、同封されているUSBをご利用いただき、アップデートをお願いいたします。

弊社では、納入設備情報管理の一環として、センサー号機と水質計本体のソフトウェア版数を記録しております。
お客様におかれましては、アップデート終了後に水質計のインフォメーション画面を撮影いただき、
[メールにてx-kansai-ce@fujielectric.com宛へお送りください。](mailto:x-kansai-ce@fujielectric.com)
お客様に充実したアフターサービスをお届けするため、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

対象濁度センサ型式：2141-200-PL-*


ダウンロードリンク

アップデート手順書 [README.pdf](#)
ソフトウェア [seasentryupdate013.tgz](#)

このステッカーが貼られた濁度センサを取付けて使用する場合、
ソフトウェアのバージョンがL0.3でないと使用できません



水質計のインフォメーション画面

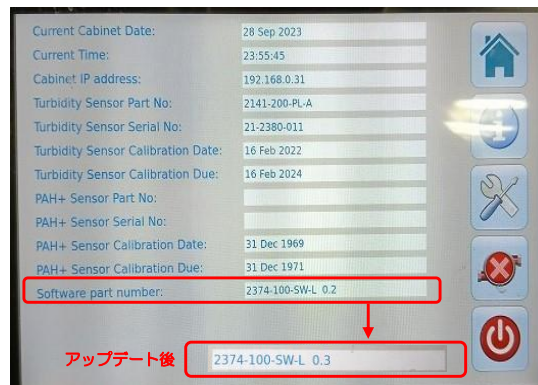

本件に関する問い合わせ先
富士電機 (株) インダストリー事業本部
FS統括部 西日本カスタマーエンジニアリングセンター
関西CE第二部CE第三課
x-kansai-ce@fujielectric.com

敬 具